

Partecipante : XXX
Campione lotto : CH-2603

Generato il 10/04/2026
 Autorizzato da RQS
 Sonia Zanghini

Analita **COLESTEROLO TOTALE**

Unità di Misura di elaborazione **mg/dL**




RDS **0,0800**

Tuo strumento **Roche Diagnostics - Roche C 501**

Tuo metodo **CHOD PAP**

Nr Partecipanti totali **287**

	Peer	Tuo metodo	Tutti i metodi
Numero misure	37	194	287
Misura	187,20		
Valore assegnato (media robusta)	187,51	186,89	186,69
Z \ Z' Score	-0,02	0,02	0,03
Deviazione Standard Robusta	8,45	12,16	12,05
Scarto tipo assegnato	15,00	14,95	14,94
Incertezza del valore assegnato	1,74	1,09	0,89
CV %	4,51	6,51	6,45
D	-0,31	0,31	0,51
D%	-0,17	0,16	0,27

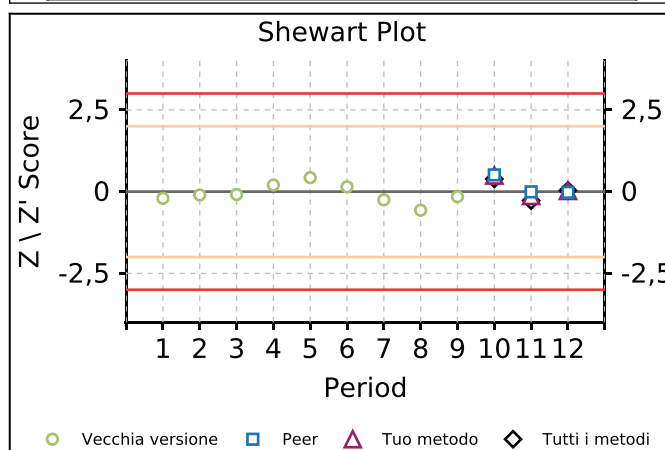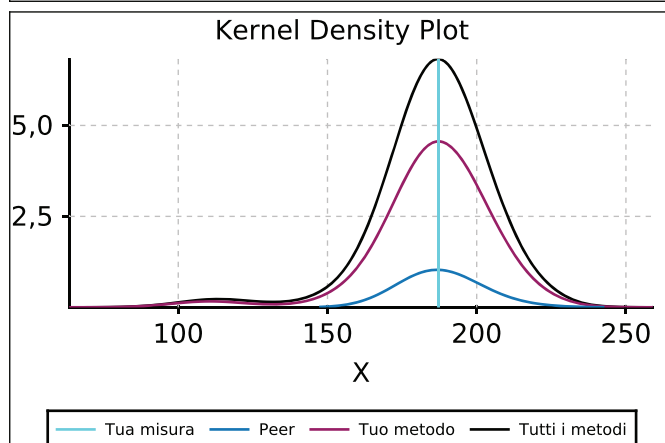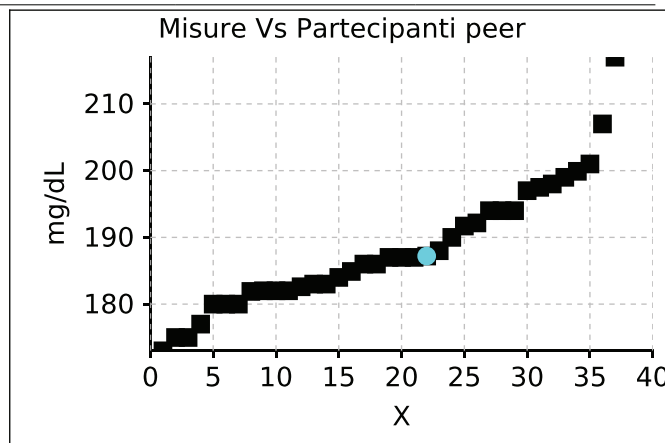

100.00% degli ultimi 18 ZScore è all'interno del range della deviazione standard -2 +2